



1.CNS 16051「具電動輔助起站及坐下機構之座椅與椅座」國家標準中，有關「座椅型式(chair type)」與「椅座型式(seat type)」可參考 CNS 16051 之圖 1，如下所示：

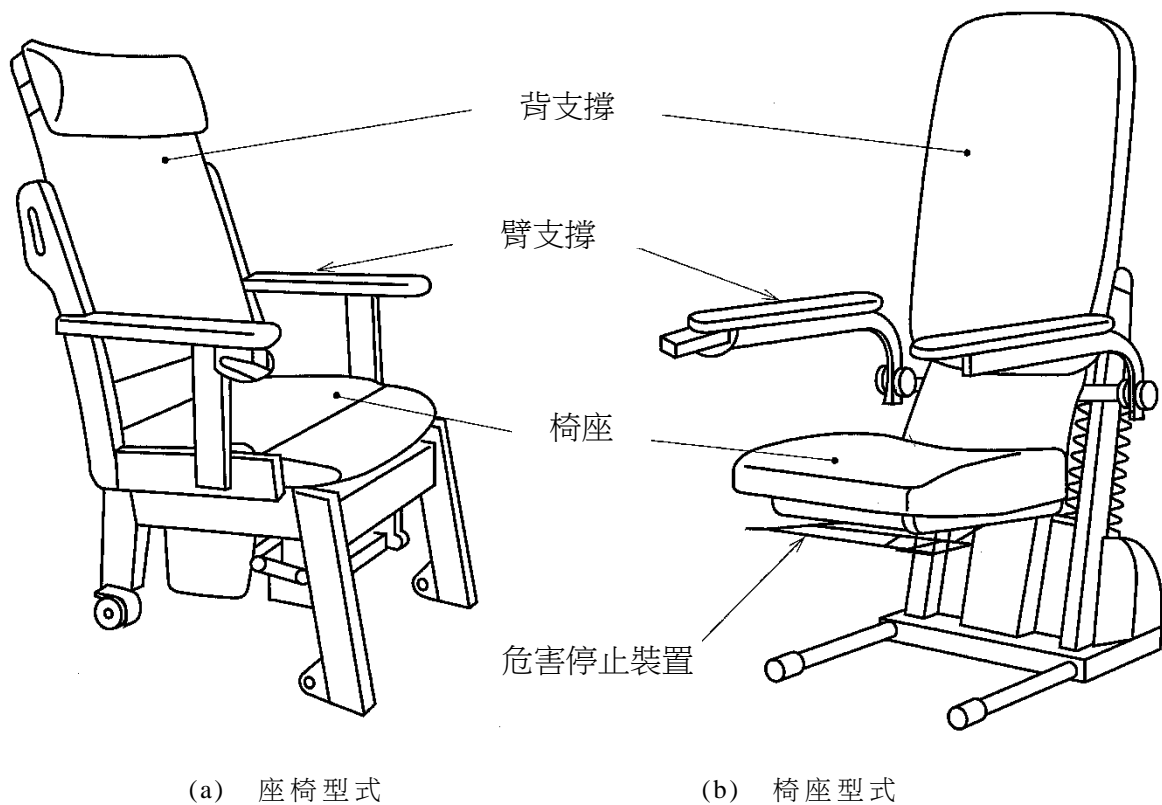

2.CNS 17190「尿失禁用尿液吸收輔具—聚合物吸收材料特性試驗法」系列標準
4種之尿失禁用尿液吸收輔具係包括紙尿褲及尿墊。

3.CNS 12821-9「識別卡—登錄技術—第9部：觸覺識別標記」識別卡之觸覺識別標記區域可參考 CNS 16051 之圖 1，如下所示。

單位：mm(in.)

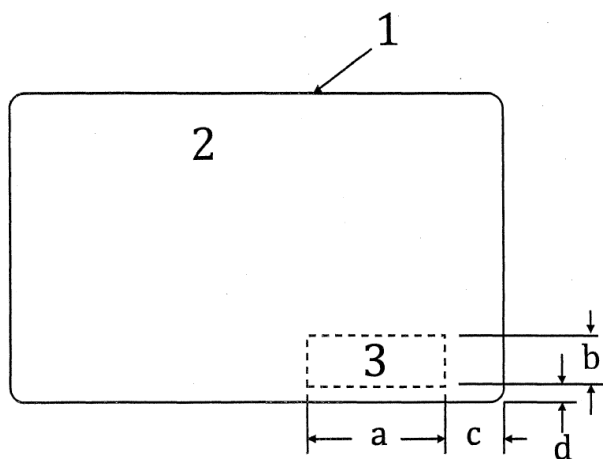

說明

- 1 頂部參考邊緣
- 2 卡片正面
- 3 TIM 區域[此區域可提供易於觸覺加以辨識的點字(Braille-style embossed dots)型樣可配置之範圍]

預設區域

- a 最大 18.5 (0.728)
- b 最大 8 (0.315)
- c 10 ± 1 (0.394 ± 0.039)
- d 2.92 ± 0.38 (0.115 ± 0.015)或 9.07 ± 0.38 (0.357 ± 0.015)

107 年公告之年高齡與身心障礙者相關國家標準一覽表
(共 12 種)

編號	標準名稱	公告日期
身心障礙者相關者(6 種)		
1	CNS 16051 具電動輔助起站及坐下機構之座椅與椅座	107 年 9 月 17 日
2	CNS 16052 輔具－床邊桌	107 年 9 月 17 日
3	CNS 16077 身心障礙者移位用起吊裝置－要求及試驗法	107 年 10 月 18 日
4	CNS 14964-26 輪椅－第 26 部：詞彙	107 年 10 月 18 日
5	CNS 14964-8 輪椅－第 8 部：輪椅靜態、衝擊與疲勞強度要求及試驗法	107 年 12 月 12 日
6	CNS 17966 支撐使用者之個人衛生輔具－要求及試驗法	107 年 12 月 12 日
高齡照護相關者(4 種)		
1	CNS 17190-1 尿失禁用尿液吸收輔具－聚合物吸收材料特性試驗法－第 1 部：pH 值之測定	107 年 9 月 17 日
2	CNS 17190-2 尿失禁用尿液吸收輔具－聚合物吸收材料特性試驗法－第 2 部：殘留單體量之測定	107 年 9 月 17 日
3	CNS 17190-3 尿失禁用尿液吸收輔具－聚合物吸收材料特性試驗法－第 3 部：以篩選分離法測定粒徑分布	107 年 9 月 17 日
4	CNS 17190-4 尿失禁用尿液吸收輔具－聚合物吸收材料特性試驗法－第 4 部：以加熱質量損失法測定含水量	107 年 9 月 17 日
與生活無礙相關者(2 種)		
1	CNS 12821-9 識別卡－登錄技術－第 9 部：觸覺識別標記	107 年 9 月 17 日
2	CNS 16066 預付卡－通則	107 年 9 月 17 日